

# PXIe 模块化 200


# V

## 单通道精密源表

### S2012C

 规格书 V1.8

基于双向开关电源及数字控制环路技术，实现精确、快速的输出特性且极大缩小板卡体积。符合标准 PXIe 协议，支持现有主流 PXIe 机箱，集成度高，支持多卡同步测试。为用户提供  $\pm 200\text{ V}$ 、 $\pm 1\text{ A}$ （直流）、 $\pm 3\text{ A}$ （脉冲）、 $20\text{ W}$  恒定功率输出，最大采样率  $1\text{ Msps}$ ，最小测量分辨率： $10\text{ fA}/100\text{ nV}$ 。

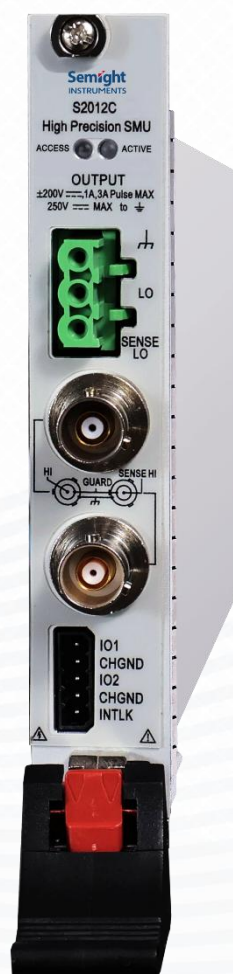

# 目录

<b>1 产品描述</b>	<b>4</b>
<b>2 产品特点和优势</b>	<b>5</b>
APFC 系统	5
最大量程	5
最小测量分辨率	6
高速测量	6
传感模式	6
SWEEP 模式	6
自动量程	7
延时测量	7
保护	7
同步触发	8
免费的 PC 端 GUI 控制软件	8
PC 系统配置	10
<b>3 技术指标</b>	<b>11</b>
源表输出能力	12
电压源设置和测量分辨率/精度	13
电流源设置和测量分辨率/精度	14
电阻测量分辨率/精度（四线）	15
脉冲源指标	16
脉冲源上升时间	17
输出建立时间	17



采样率及 NPLC 设置.....	18
测量精度降额.....	18
环境指标.....	19
<b>4 采购信息.....</b>	<b>20</b>
<b>5 维保条款.....</b>	<b>21</b>



## 2 产品特点和优势

### APFC 系统

联讯仪器 S2012C PXIe 精密源表支持用户修改 APFC (Adaptive Precision-Fast Control) 参数，用户可根据负载特性，调整相关参数来获得精确、快速的输出特性。



APFC 调整前后波形对比

### 最大量程

最大支持 $\pm 200\text{ V}$ 、 $\pm 1\text{ A}$ （直流）、 $\pm 3\text{ A}$ （脉冲）输出，双卡即可轻松地实现 LIV 扫描。

## 最小测量分辨率

最低电流测量分辨率低至 10 fA，电压测量分辨率低至 100 nV，可以使用低成本的板卡式 SMU 进行低电平测量，而以前则需要使用昂贵的半导体器件分析仪。

## 高速测量


最高可支持 1 Msps 的 ADC 采样率，NPLC 和采样率可选。

## 传感模式

支持 2 线或 4 线（远程传感）连接；最大传感引线电阻：1 k $\Omega$ （额定精度）；远程传感输出端与传感端最大电压：2 V。

## SWEEP 模式

支持单边和双边的线性、对数、列表扫描。间隔从 1  $\mu$ s 至 16 s 可配置，单次扫描最大  $10^6$  个点。

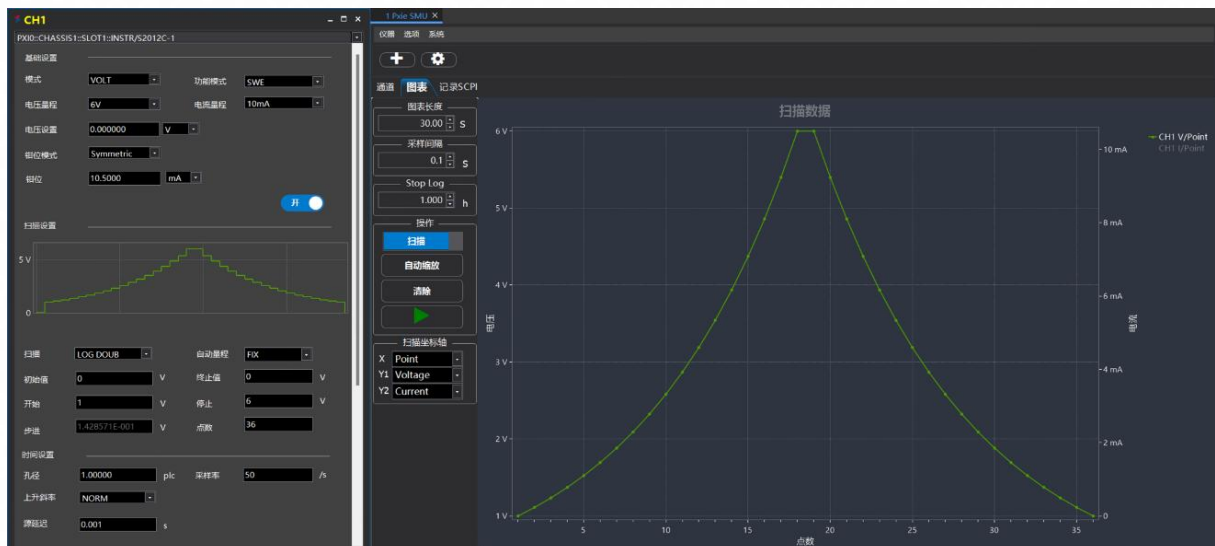


双边对数扫描

## 自动量程

支持单点, 扫描自动量程。过冲敏感设备建议切换量程前关闭输出再做量程切换动作。

## 延时测量

支持延时测量 (Source Delay), 建议用户设置合适的 Source Delay 以获得更准确的测量值。Source Delay 必须大于源建立的时间, 特别是小电流量程, 当采样值不准时需要考虑 Source Delay 是否合理。

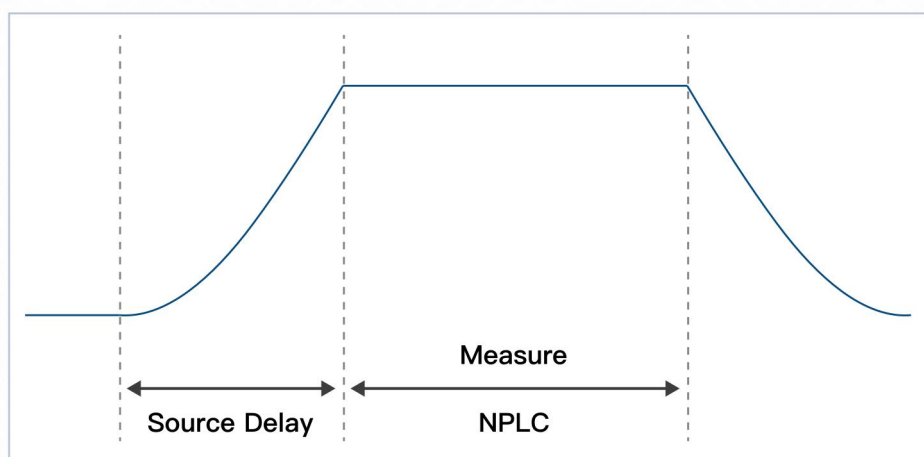

Source Delay 设置示意图

## 保护

- 支持过温保护, 当检测到内部温度过高时, 关断系统电源;
- 其他过流过压保护, 当发生时板卡亮红灯, 发硬件复位命令或断电重启, 可恢复操作;
- 板卡灯不亮可能硬件损坏。


## 同步触发

- 支持多卡内外部（内部为 8 根 Trig Bus0-7，外部为 2 根 DIO1-2）同步触发功能（TRIG BUS）；配置内部 Trig IO，确保多卡在机箱的同一路由段。如不在同一路由段，可通过机箱的上位机将内部 Trig IO 路由到对应的 IO；
- 内外部触发需遵循以下原则：一个通道可配置多个 IO 为触发输出，但同时只能配置一个 IO 为触发输入；一个 IO 可被多个通道配置触发输入，但一个 IO 同时只能被一个通道配置为触发输出；
- 脉宽：100 ns~1 ms 可设置；高电平有效；
- 外部 DIO 触发电平：

DIO 接口参数	最大额定值
绝对最大输入电压	5.25 V
绝对最小输入电压	-0.25 V
最小逻辑高电平	2.1 V
最高逻辑低电平	0.7 V
最大逻辑输出电流	2 mA
最大吸电流	-50 mA

## 免费的 PC 端 GUI 控制软件

无需编程即可从 PC 进行远程测量和控制。

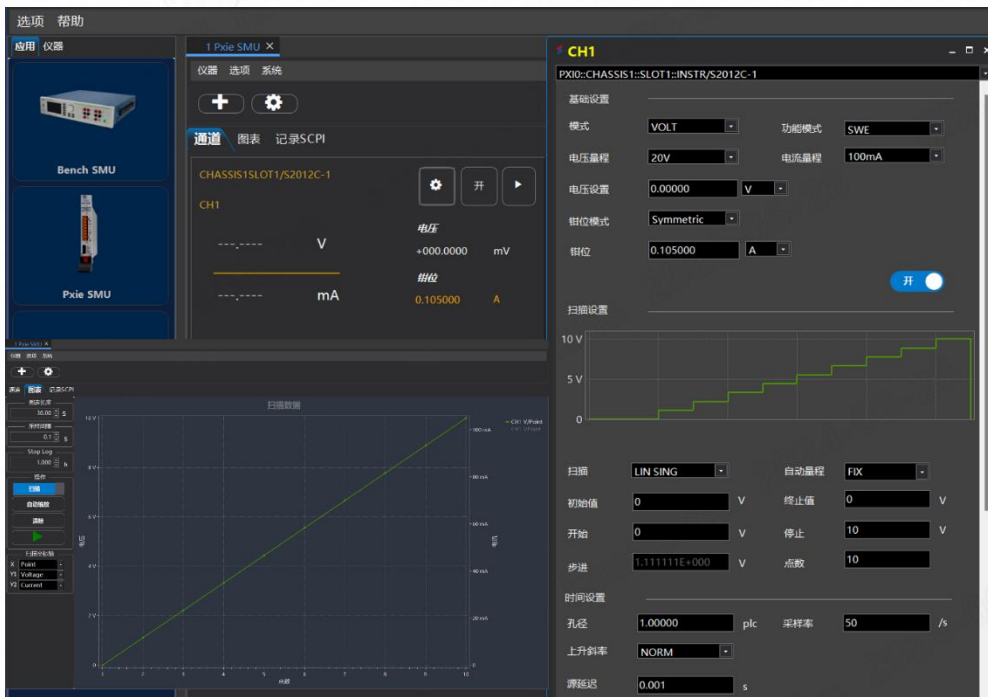

GUI 界面

## PC 系统配置

- Intel I7 或更高
- 8 GB 存储器（基于实际应用需增加）
- Windows 11 / Windows 10 (64 位) / Windows 7 (64 位, 安装驱动需要打补丁)
- 配置运行板卡需要安装 Semight 驱动。

# 3 技术指标

工作条件:

温度  $23^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ;

湿度 30%至 60%相对湿度;


预热 60 分钟后测量, 测量时环境温度变化小于 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ;

校准周期 1 年;


测量速度 1 PLC;

如果 PXIe 机箱有多个风扇转速设置, 请将风扇转速设置成最大。

## 源表输出能力

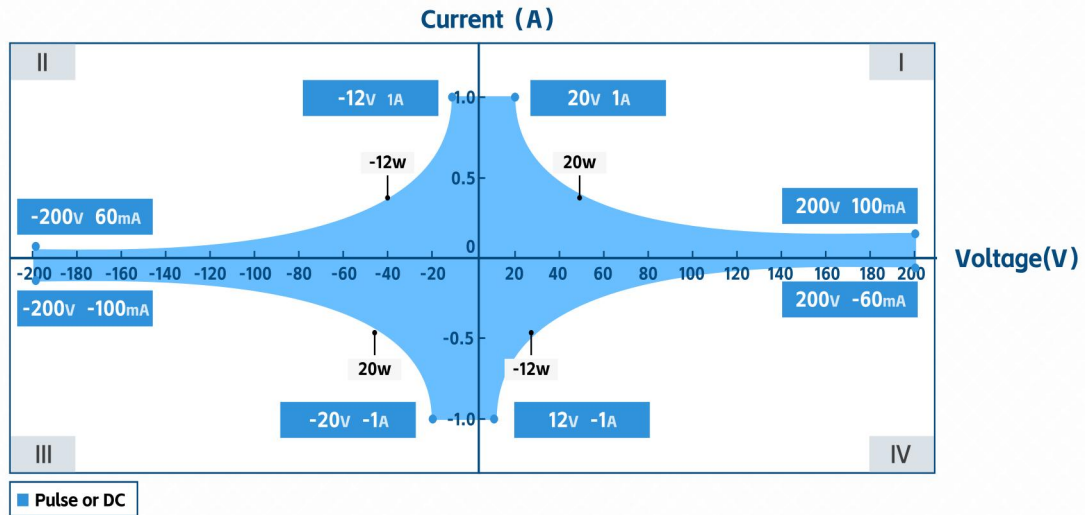

直流 I-V 输出能力

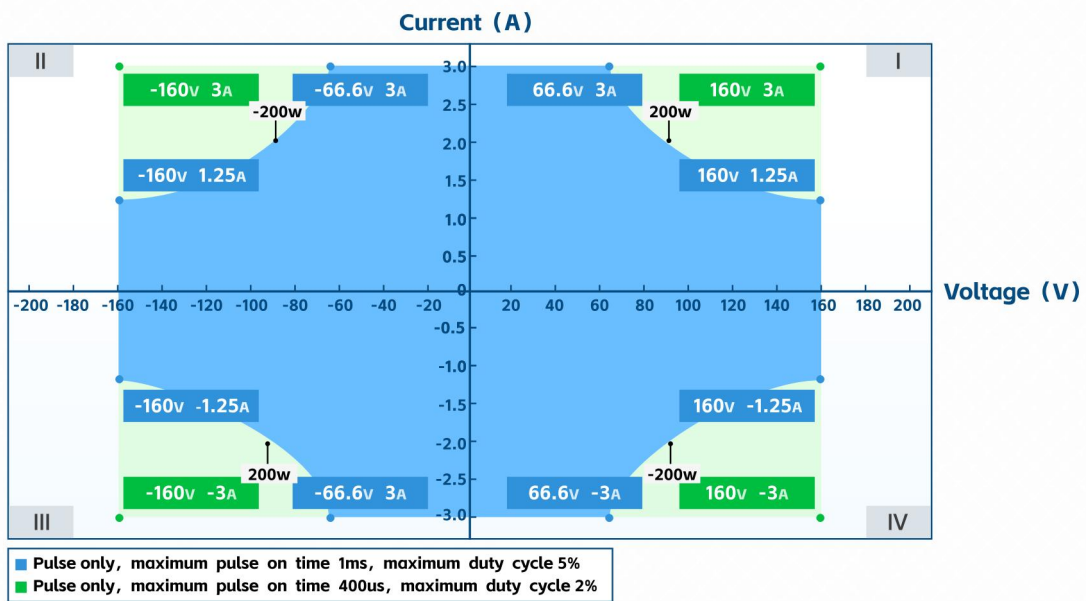

脉冲 I-V 输出能力

## 电压源设置和测量分辨率/精度

	量程	分辨率	精度 (1年) ± (%读数+偏置) <sup>[1]</sup>	典型噪声 (有效值) 0.1 Hz-10 Hz
电压精度	±200 V <sup>[2]</sup>	100 μV	0.03%+10 mV	0.4 mV
	±20 V	10 μV	0.03%+1 mV	50 μV
	±6 V	1 μV	0.03%+0.4 mV	12 μV
	±0.6 V	100 nV	0.03%+100 μV	3 μV
温度系数	± (0.15×精度指标) /°C (0°C-18°C, 28°C-50°C)			
过冲	<±0.1% (典型值, Normal, 步进是范围的 10%至 90%, 满量程点, 电阻性负载测试)			
噪声 10 Hz- 20 MHz	<5 mVrms , 20 V 电压源, 1 A 电阻负载			

[1] 精度计算示例: 测试 600 mV 量程 120 mV 输出的精度, 则允差为:

$$\pm \left( \underbrace{120}_{\text{读数}} \times 0.03\% + \underbrace{0.1}_{\text{偏置}} \right) \text{ mV} = \pm 0.136 \text{ mV}$$

[2] 本仪表有潜在的危險高压 (±210 V) 输出到 HI/Sense HI/Guard 端子, 为防止电击, 在开机前必须做好相关的安全防范措施。请勿将 Guard 端子接到任何输出, 包括短接到机箱地或是输出 LO, 否则会损坏仪表。

## 电流源设置和测量分辨率/精度

	量程	分辨率	精度 (1年) ± (%读数+偏置)	典型噪声 (有效值) 0.1 Hz-10 Hz
电流精度	±3 A <sup>[3]</sup>	1 μA	0.03%+2 mA	40 μA
	±1 A	100 nA	0.03%+90 μA	7 μA
	±100 mA	10 nA	0.03%+9 μA	600 nA
	±10 mA	1 nA	0.03%+900 nA	60 nA
	±1 mA	100 pA	0.03%+90 nA	6 nA
	±100 μA	10 pA	0.03%+9 nA	700 pA
	±10 μA	1 pA	0.03%+1 nA	80 pA
	±1 μA <sup>[4]</sup>	100 fA	0.03%+200 pA	20 pA
	±100 nA <sup>[4][5]</sup>	100 fA	0.06%+30 pA	3 pA
	±10 nA <sup>[4][5]</sup>	10 fA	0.06%+9 pA	600 fA
温度系数	± (0.15×精度指标) /°C (0°C-18°C, 28°C-50°C)			
过冲	<±0.1% (典型值, Normal, 步进是范围的 10%至 90%, 满量程点, 电阻性负载测试)			

[3] 3 A 量程仅支持脉冲模式, 精度为典型值。

[4] 微弱小电流测量, 建议保持使用三同轴线缆连接, 若使用三同轴端子转为普通接线的输出方式, 会影响仪表的电流精度。


[5] 附加规格条件: NPLC 配置 10 PLC。

## 电阻测量分辨率/精度 (四线)

	量程	显示分辨率	默认测试电流	典型精度 (1年) ± (%读数+偏置)
电阻测量精度	600 mΩ	100 nΩ	1 A	0.07%+100 μΩ
	6 Ω	1 μΩ	100 mA	0.07%+1 mΩ
	60 Ω	10 μΩ	10 mA	0.07%+10 mΩ
	600 Ω	100 μΩ	1 mA	0.07%+100 mΩ
	6 KΩ	1 mΩ	100 μA	0.07%+1 Ω
	60 KΩ	10 mΩ	10 μA	0.07%+10 Ω
	600 KΩ	100 mΩ	1 μA	0.08%+100 Ω
	6 MΩ	1 Ω	100 nA	0.12%+1 KΩ
	60 MΩ	10 Ω	10 nA	0.18%+10 KΩ
	600 MΩ	100 Ω	1 nA	1%+100 KΩ
温度系数	± (0.15×精度指标) /°C (0°C-18°C, 28°C-50°C)			
手动电流源 电阻测量 (四线)	<p>总体误差=测量电压/电流源设定电流=电阻读数 × (电压源量程的增益误差百分比 + 电流表量程的增益误差百分比 + 电流源量程偏置误差/设定电流) + (电压源量程偏置误差/设定电流值)</p> <p>示例: 电流源设定电流=1 A 电压测量量程=600 mV</p> <p>总体误差= (0.03%+0.03%+90 μA/1 A) + (100 μV/1 A) ≈ 0.07%+100 μΩ</p>			

## 脉冲源指标

指标项	规格指标
最小可编程脉宽	100 $\mu\text{s}$
脉宽编程分辨率	1 $\mu\text{s}$
脉宽编程精度	$\pm 10 \mu\text{s}$
脉宽抖动	2 $\mu\text{s}$
脉冲宽度定义	如图所示，从 10%前沿到 90%后沿的时间

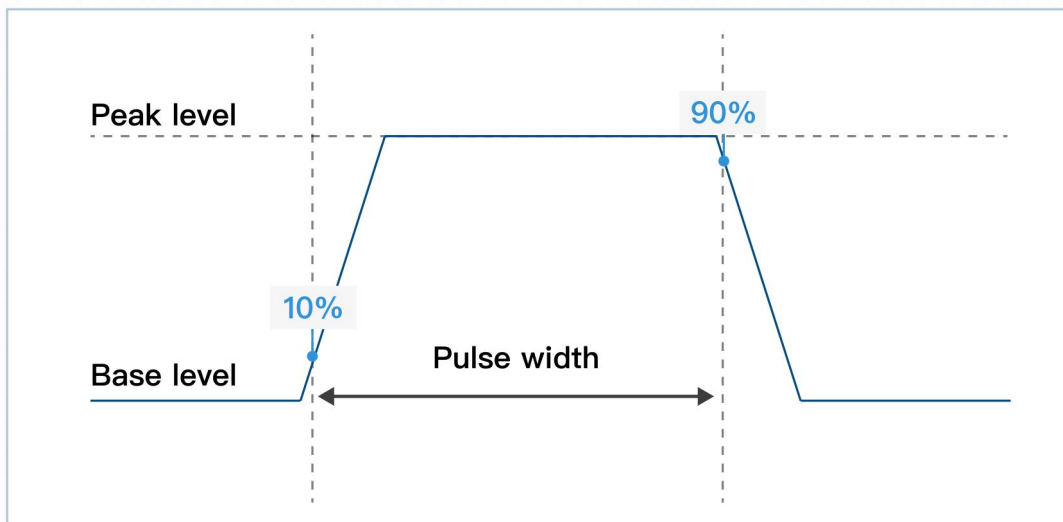

脉冲宽度定义

最大电流限制	最大脉冲宽度	最大占空比
0.1 A/200 V	DC, 无限制	100%
1 A/20 V	DC, 无限制	100%
3 A/66.6 V	1 ms	5%
3 A/160 V	400 $\mu\text{s}$	2%

## 脉冲源上升时间

输出	最大输出	上升时间 <sup>[6]</sup>	稳定时间 <sup>[7]</sup>	测试负载
电压源	160 V	800 $\mu$ s	1.2 ms	空载
	5 V	80 $\mu$ s	200 $\mu$ s	空载
电流源	3 A~1 mA	120 $\mu$ s	250 $\mu$ s	带满载 <sup>[8]</sup>
	100 $\mu$ A~10 $\mu$ A	200 $\mu$ s	400 $\mu$ s	带满载 <sup>[8]</sup>
	1 $\mu$ A	800 $\mu$ s	2 ms	带满载 <sup>[8]</sup>
	100 nA	2 ms	5 ms	带满载 <sup>[8]</sup>
	10 nA	5 ms	20 ms	带满载 <sup>[8]</sup>

[6] 脉冲前沿从 10%到 90%所需的时间。

[7] 脉冲达到距离最终值 1%的所需的时间。

[8] 测试条件：Normal 纯阻满载电压上升到 6 V。

## 输出建立时间

输出	量程	输出建立时间 <sup>[9]</sup>			测试条件
		Fast <sup>[10]</sup>	Normal	Slow	
电压源	200 V	<500 $\mu$ s	<1.2 ms	<2 ms	在开路负载条件下，达到距离最终值 0.1%以内所需的时间，步进是范围 10%至 90%。
	20 V	<100 $\mu$ s	<200 $\mu$ s	<600 $\mu$ S	
	6 V	<90 $\mu$ s	<180 $\mu$ s	<300 $\mu$ s	
	0.6 V	<80 $\mu$ s	<80 $\mu$ s	<80 $\mu$ s	

电流源	3 A~1 mA	<70 $\mu$ s	<200 $\mu$ s	<0.8 ms	在 Normal 条件满载下, 电压输出达到 6 V。达到距离最终值 0.1%以内 (对于 3 A 范围, 为 0.3%) 所需的时间, 步进是范围 10% 至 90%。
	100 $\mu$ A	<100 $\mu$ s	<200 $\mu$ s	<0.8 ms	
	10 $\mu$ A	<200 $\mu$ s	<300 $\mu$ s	<0.8 ms	
	1 $\mu$ A	<1.5 ms	<1.5 ms	<1.5 ms	
	100 nA	<3 ms	<3 ms	<3 ms	
	10 nA	<10 ms	<10 ms	<10 ms	

[9] 输出转换速率: Fast, Normal, Slow。用户可自行根据负载特性调节 APFC 参数以获得合适的建立时间或稳定性。

[10] Fast 模式在不同的量程或负载条件下输出可能会出现较大过冲, 过冲敏感设备建议用 Normal 或者 Slow 模式。

## 采样率及 NPLC 设置

配置方式	配置范围
NPLC	0.00005 PLC~10 PLC
Sampling Rate	5 sps~1 Msps

## 测量精度降额

误差增加量程的百分比 (PLC < 1)。

PLC	量程							
	600 mV	6 V	20 V	200 V	10 nA 至 1 $\mu$ A	10 $\mu$ A	100 $\mu$ A 至	1 A 至

							100 mA	3 A
0.1	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%
0.01	0.3%	0.3%	0.03%	0.02%	0.2%	0.04%	0.02%	0.02%
0.001	3.2%	3.2%	0.4%	0.1%	2.5%	0.4%	0.03%	0.03%

## 环境指标

环境指标	规格/要求
环境	在室内设施中使用
工作	0°C至+50°C, 30%至 60%相对湿度无冷凝
储存	-30°C至 70°C, 10%至 90%相对湿度无冷凝
尺寸 (mm)	210×130×20
重量	净重: 0.46 kg
供电	满载: 12 V/3.5 A; 3.3 V/0.5 A; 5 V/0.01 A
海拔	工作高度: 0 m 至 2000 m, 储存高度: 0 m 至 4600 m
污染等级	2
预热	1小时

## 4 采购信息

标准出厂附件：输出连接器（不带线），DIO 连接器（不带线），安装软件 U 盘（上位机软件及产品驱动，PDF 产品规格书，操作手册）。

产品型号	
S2012C	PXIe 模块化 200 V 单通道精密源表
可选附件	
TA-01003	输出扩展连接装置，三同轴转接线端子，250 V，1 A
耗材/配件	
TA-03001	三同轴输出线，公对公，0.6 米，250 V，1 A
TA-03002	三同轴输出线，公对公，1.5 米，250 V，1 A
TA-03003	三同轴输出线，公对公，4 米，250 V，1 A
服务	
R3C	原厂扩展维保服务计划-36 个月
R5C	原厂扩展维保服务计划-60 个月

## 5 维保条款

序号	项目	内容	时限
1	主机保修期	保修期内免费维修	12 个月
2	可选附件	耗材/配件不在保修范围	3 个月
3	校准周期	联讯厂校或就近联讯维修中心校准	12 个月

## 联系我们

苏州联讯仪器股份有限公司

## 邮箱

[sales@semight.com](mailto:sales@semight.com)

## 地址

苏州市高新区泰山路 315 号

## 官网

更多信息请访问 [www.semight.com](http://www.semight.com)

\*本文中的产品指标和说明可不经通知而更新